


Super Ergo Base/ Super Ergo Base/ Base Super Ergo/
Super Ergo Base/ Base Super Ergo/ Super Ergo 人體工學基座/
超級 Ergo 底座

SB7S17S/ SB7S17A
SB7S17B

Quick start guide

Guide de démarrage rapide / Guía rápida / Kurzanleitung /
Guida rapida / 快速入門指南 / 快速入门指南

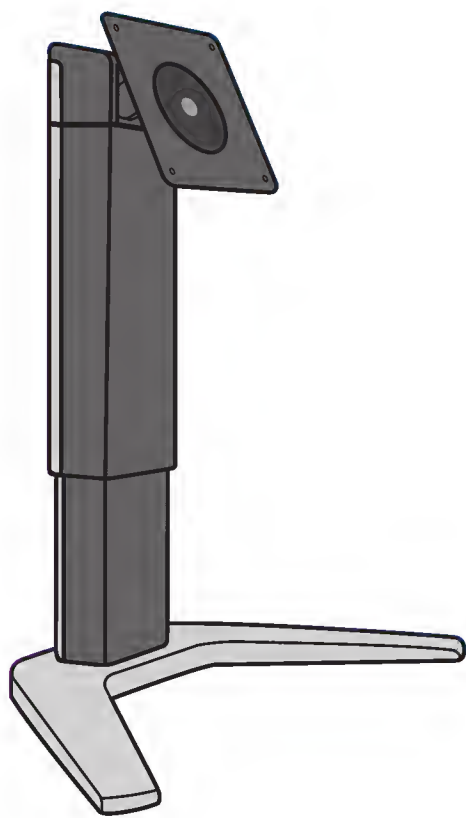

1 To install the base

Um den Monitorfuß zu montieren /
Pour installer la base /
Per installare la base /
Para instalar la base /
如何安裝基座 / 安裝底座步驟


2 How to remove the base

Um den Monitorfuß abzunehmen /
Comment retirer la Base /
Come rimuovere la base /
Cómo quitar la base /
如何拆除基座 / 拆除底座步驟

3 Ergonomic Adjustments


Régler les ergonomiques /
Ajustes ergonómicos /
Ergonomische /
Einstellmöglichkeiten /
Regolazioni ergonomiche /
人體工學調整 / 人体工学调整

Artwork: Super Ergo Base Quick Start Guide
Extend: 4pp + 4pp
Size: Open: 594W x 210Hmm Close: 148.5W x 210H (mm)
Material: 150gsm White, woodfree coated
Printing: ONE side printing - 2C x 2C – Pantone 3005C + Black
Finishing: Folded sheet
Date prepared: 11 July 2006

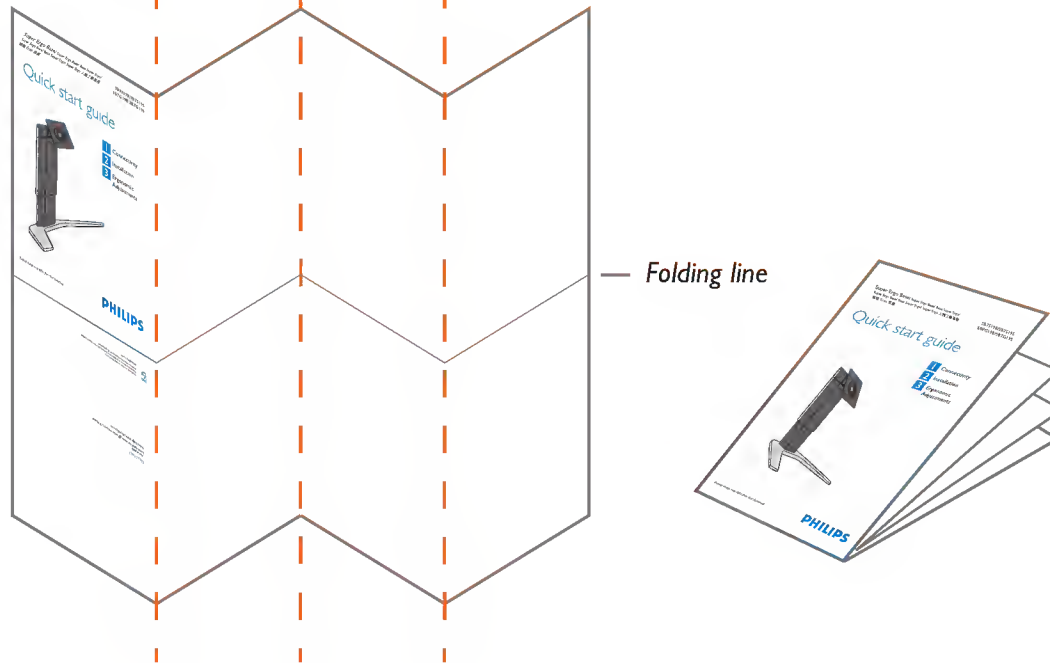

What's in the box


Contenu de la boîte / Contenido del embalaje /
Lieferumfang / Contenuto della confezione /
包装盒内的物品清单 / 包装盒內物品清單

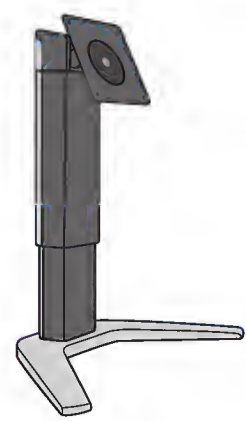

Super Ergo Base
① Super Ergo Base
② Base Super Ergo
③ Super Ergo Base
④ Base Super Ergo
⑤ Super Ergo 人體工學基座
⑥ 超級 Ergo 底座



Quick start guide
① Guide de démarrage rapide
② Guía rápida
③ Kurzanleitung
④ Guida rapida
⑤ 快速入門指南
⑥ 快速入门指南

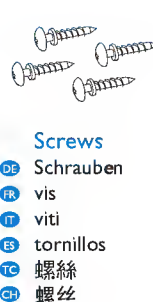

Screws
① Schrauben
② vis
③ tornillos
④ 螺絲

PHILIPS

Display design may differ from that illustrated


Specifications are subject to change without notice.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
www.philips.com



Need help?
User manual
See the digital User manual that comes with your LCD Monitor.
Online help: www.pdc.philips.com
H75B17SQ1

Warning

Before removing the base from the monitor, set the base to its maximum extension, and place the monitor face down on a safe, smooth surface. When the base is not in its maximum extension, it may cause the injury to the user.

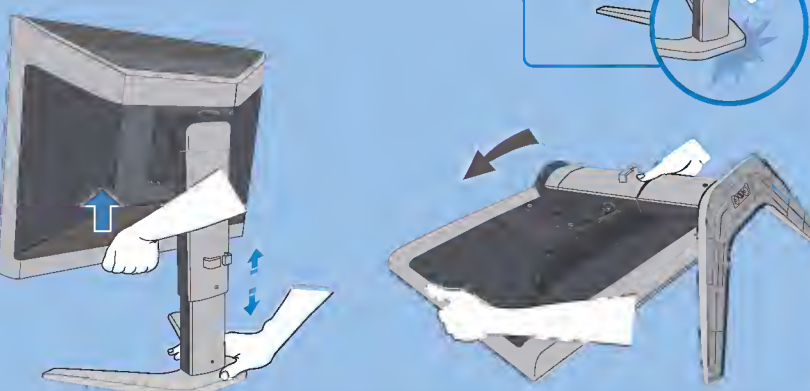


- ① **Warnung:**
Vor dem Entfernen des Sockels vom Monitor muss der Sockel auf Maximum ausgezogen werden. Danach den Monitor mit der Vorderseite nach unten auf eine sichere und ebene Oberfläche legen. Falls der Sockel nicht bis zum Maximum ausgezogen ist besteht für den Benutzer eine Verletzungsgefahr.
- ② **Avertissement:**
Avant de retirer la base du moniteur, tirez la base en extension maximum, et placez le moniteur sur une surface lisse et stable avec l'écran tourné vers le bas. Lorsque la base n'est pas en extension maximum, vous pouvez vous blesser.
- ③ **Avvertenza:**
Prima di rimuovere la base dal monitor, impostare la base con la massima estensione, e mettere il monitor con lo schermo appoggiato su una superficie sicura e liscia quando la base non è nella sua massima estensione, può provocare lesioni all'utente.
- ④ **Aviso:**
Antes de sacar la base del monitor, establezca la base a su extensión máxima, y coloque el monitor cara abajo sobre una superficie firme y suave. Si la base no está en su máxima extensión, podrá causarse una lesión al usuario.
- ⑤ **警告:**
自顯示器上拆除 Super Ergo 人體工學基座前，基座需為最大基座展開位置，再將顯示器面向下置於安全的表面。若顯示器為直立狀態且為基座最小展開位置時，自 Super Ergo 人體工學基座拆下顯示器，可能會讓使用者受傷。
- ⑥ **注意事項:**
从顯示器拆除底座之前，底座伸展距離須為最大，再將顯示器面向下放在安全表面上。底座的垂直伸展距離最小時从底座拆除顯示器可能会对用户造成伤害。

To install the base

Um den Monitorfuß zu montieren / Pour installer la base / Per installare la base /
Para instalar la base / 如何安裝基座 / 安裝底座步驟


A Put monitor face down on the safe surface

- ① Legen Sie den Monitor mit der Bildschirmseite nach unten auf eine feste Unterlage
- ② Placez le moniteur écran tourné vers le bas sur une surface lisse
- ③ Posizionare il monitor appoggiando lo schermo su una superficie sicura
- ④ Coloque el monitor hacia abajo en una superficie segura
- ⑤ 顯示器面向下置於安全的表面
- ⑥ 將顯示器面向下放在安全的表面上



B Mount the base onto the monitor body and fix four screws securely

- ① Setzen Sie den Monitorfuß auf den Monitor auf und befestigen ihn sorgfältig mit den vier Schrauben.
- ② Montez la base sur le corps du moniteur et fixez fermement à l'aide des quatre vis
- ③ Montare la base sul corpo del monitor e stringere le quattro viti
- ④ Monte la base en el cuerpo del monitor y apriete bien los cuatro tornillos
- ⑤ 將顯示器固定於基座上，旋緊四顆螺絲
- ⑥ 將底座安裝到顯示器機身上，并拧紧四个螺丝




C Pull back up the monitor body

- ① Stellen Sie den Monitor wieder auf
- ② Mettez le corps du moniteur d'aplomb
- ③ Tirare su nuovamente il corpo del monitor
- ④ Tire hacia arriba del cuerpo del monitor
- ⑤ 往上拉回顯示器
- ⑥ 向后拉顯示器机身



D Connect to PC

- ① Schließen Sie den PC an
- ② Connectez le PC
- ③ Connettere il PC
- ④ Conecte el PC
- ⑤ 連接至PC
- ⑥ 连接 PC

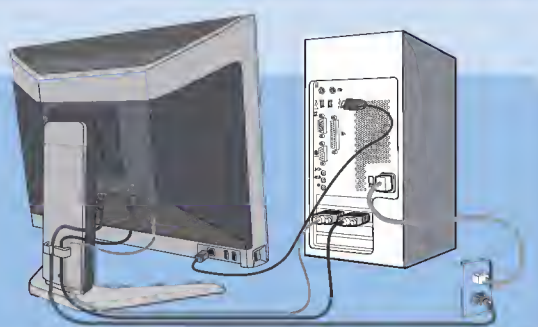

How to remove the base

Um den Monitorfuß abzunehmen / Comment retirer la Base / Come rimuovere la base /
Cómo quitar la base / 如何拆除基座 / 拆除底座步驟


A Put monitor face down on the safe surface

- ① Legen Sie den Monitor mit der Bildschirmseite nach unten auf eine feste Unterlage
- ② Placez le moniteur écran tourné vers le bas sur une surface lisse
- ③ Posizionare il monitor appoggiando lo schermo su una superficie sicura
- ④ Coloque el monitor hacia abajo en una superficie segura
- ⑤ 顯示器面向下置於安全的表面
- ⑥ 將顯示器面向下放在安全的表面上



B Unscrew the four screws of the base

- ① Lösen Sie die vier Schrauben des Monitorfußes
- ② Dévissez les quatre vis de la base
- ③ Svitare le quattro viti della base
- ④ Afloja los cuatro tornillos de la base
- ⑤ 取出基座的四顆螺絲
- ⑥ 旋松底座的四个螺丝




Ergonomic Adjustments

Régler les ergonomiques / Ajustes ergonómicos / Ergonomische Einstellmöglichkeiten / Regolazioni ergonomiche / 人體工學調整 / 人体工学调整


A Height adjustment

- ① HöhenEinstellung
- ② Réglage en hauteur
- ③ Regolazione altezza
- ④ Regulación de altura
- ⑤ 高度調整
- ⑥ 高度調整

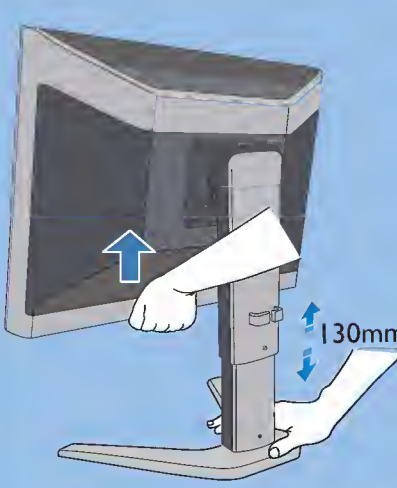

B Portrait display


- ① Hochformatdarstellung
- ② Affichage format portrait
- ③ Display verticale
- ④ Posición vertical
- ⑤ 垂直顯示
- ⑥ 垂直顯示

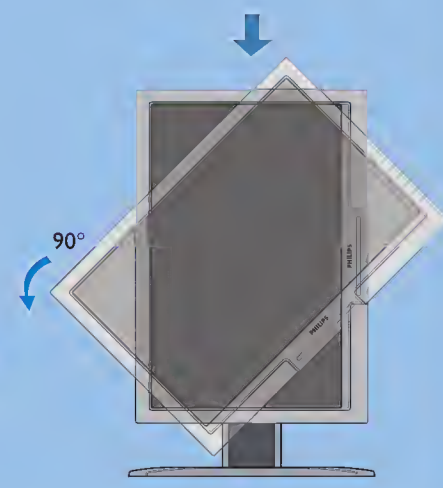

- ⑦ * **SB7S17S** This Super Ergo Base is specially designed for Philips 17057, 170V7 LCD monitors.
- ⑦ * **SB7S17A** This Super Ergo Base is specially designed for Philips 170A7 LCD monitor.
- ⑦ * **SB7S17B** This Super Ergo Base is specially designed for Philips 170B7 LCD monitor.
- ⑧ * **SB7S17S** Dieser Monitorfuß wurde speziell für die Philips LCD-Monitore 17057, 170V7 konzipiert.
- ⑧ * **SB7S17A** Dieser Suoer-Ergo-Sockel ist speziell für den Philips 170A7 LCD-Monitor ausgeführt worden.
- ⑧ * **SB7S17B** Dieser Suoer-Ergo-Sockel ist speziell für den Philips 170B7 LCD-Monitor ausgeführt worden.
- ⑨ * **SB7S17S** Spécialement conçue pour les moniteurs LCD Philips 17057, 170V7
- ⑨ * **SB7S17A** Cette base Super Ergo a été spécialement conçue pour les écrans LCD Philips 170A7
- ⑨ * **SB7S17B** Cette base Super Ergo a été spécialement conçue pour les écrans LCD Philips 170B7
- ⑩ * **SB7S17S** Questa Base Super Ergo è stata progettata specificamente per i monitor LCD Philips 17057, 170V7
- ⑩ * **SB7S17A** Questa Base Super Ergo è disegnata specificamente per il monitor LCD Philips 170A7
- ⑩ * **SB7S17B** Questa Base Super Ergo è disegnata specificamente per il monitor LCD Philips 170B7


C Tilt

- ① Kippen
- ② Réglage de l'inclinaison
- ③ Réglae de la rotacion
- ④ Rotazione orizzontale
- ⑤ Plataforma giratoria
- ⑥ 旋轉
- ⑦ 旋轉

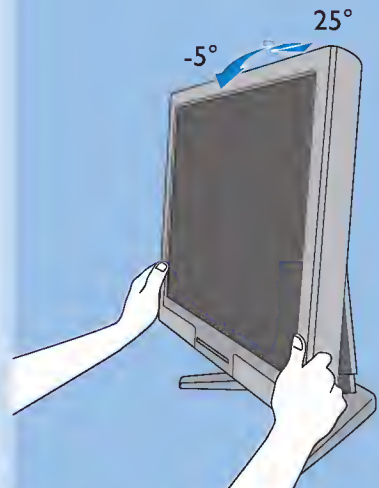

D Swivel

- ① Swivelen
- ② Réglage de la rotation
- ③ Réglae de la rotacion
- ④ Rotazione orizzontale
- ⑤ Plataforma giratoria
- ⑥ 旋轉
- ⑦ 旋轉

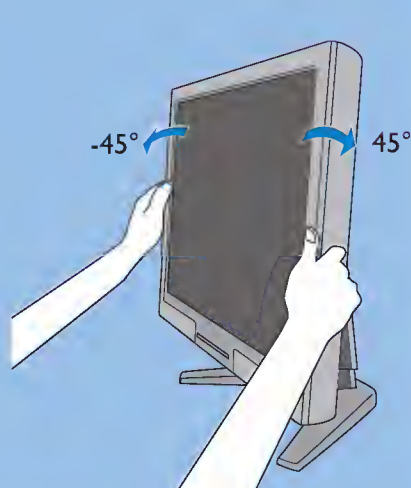

- ⑦ * **SB7S17S** Esta Base Super Ergo está especialmente diseñada para los monitores LCD Philips 17057, 170V7
- ⑦ * **SB7S17A** Esta Base Super Ergo está especialmente diseñada para el monitor LCD Philips 170A7
- ⑦ * **SB7S17B** Esta Base Super Ergo está especialmente diseñada para el monitor LCD Philips 170B7
- ⑧ * **SB7S17S** 專門為Philips 17057, 170V7 LCD 顯示器而設計。
- ⑧ * **SB7S17A** 專門為Philips 170A7 LCD 顯示器而設計。
- ⑧ * **SB7S17B** 專門為Philips 170B7 LCD 顯示器而設計。
- ⑨ * **SB7S17S** 專門為Philips 17057, 170V7 LCD 顯示器而設計。
- ⑨ * **SB7S17A** 專門為Philips 170A7 LCD 顯示器而設計。
- ⑨ * **SB7S17B** 專門為Philips 170B7 LCD 顯示器而設計。